

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 15/15PN/2019/13

Bytom dnia: 2019-06-28

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x120mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza,

Pakiet 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x40mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x90mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści igły 20G 0,9x75mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści igły 22G 0,7x75mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści oświadczenie dystrybutora potwierdzające kompatybilność koreczka z kaniulą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 12 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra 450x180mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 14 poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z kolcem posiadającym odpowietrznik?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone pakowane prosto, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ostrza w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 33 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarach:
S- 290mm-355mm, M- 310mm-375mm, L- 330-395mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 36 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 36 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,12mm i na dłoni 0,09mm z poziomem protein poniżej 50µg/g spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 36 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,06mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem typu rzep w okolicy karku: lewy rzep 3cm x 13cm i prawy rzep 3cm x 7cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z trokami klejonymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M - 124cm, L - 128cm, XL - 138cm, XXL - 157cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania suchy/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na suchy/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

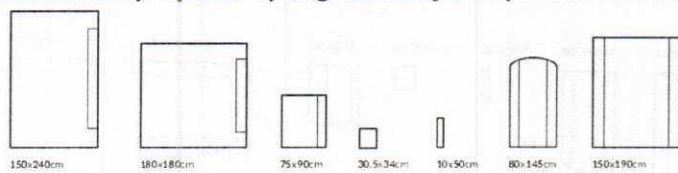

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Oslona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

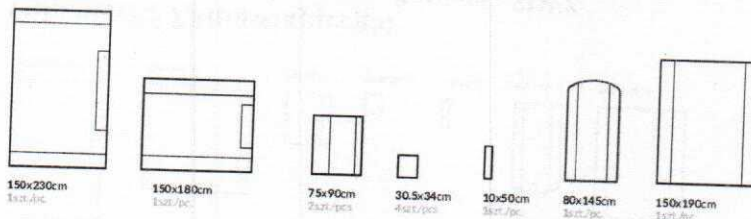

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 40 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową w rozmiarze 45cmx75cm z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 40 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową w rozmiarze 45cmx45cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 40 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną jałową w rozmiarze 45cmx60cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 46, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających 35 zszywek, wielkość grzbietu 7,2mm, grubość 0,6mm, bez powleczenia teflonem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x320cm o średnicy 15cm wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 110cm H₂O?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład laminowany wzmocniony o parametrach:

- Wykonany z pulpy laminowanej
- Wzmocniony 48 nitkami
- Rozmiar: 80 x 210 cm
- Gramatura: 23 gr (papier) + 15 gr (laminat)
- Miękki, wodoodporny, chłonny, wytrzymały
- Kolor: biały
- Jednorazowego użytku
- Niesterylny

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 81 poz. 5-7

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne barwione nie przeziernie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 81 poz. 5-7, 11

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 81 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane a'90szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 81 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści butelki z tworzywa jasnego, nieprzeziernego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 81 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane a'144szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 85 poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 86 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski w kolorze białym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 87 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 87 poz. 2, 4,5

Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 87 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 108 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło chłonne o parametrach:

- 5 warstwy: włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE
- Wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent SAP, pulpa)
- Rozmiar: 100 cm x 225 cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm
- Chłonność 3820,18 ml.
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 109 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice wolne od ftalanów PHT z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu o długości 240mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

